

Seringas sem desconexão rápida A-dec

Conteúdos

Operações básicas.....	1
Ajustes.....	4
Assepsia	6
Especificações, garantia e assistência aos produtos ...	8



Operações básicas


Funções de água, ar e de spray

Utilize os botões para controlar as funções de água, ar e de spray.
Pressione ambos os botões em simultâneo para acionar a função tríplice (ar/água/spray).



Ponta da seringa

As pontas de seringa A-dec possuem três ranhuras de bloqueio, que mantêm a ponta no respetivo lugar quando adequadamente instalada e evitam a projeção da ponta durante a utilização. As pontas estão marcadas com o “a” da A-dec.

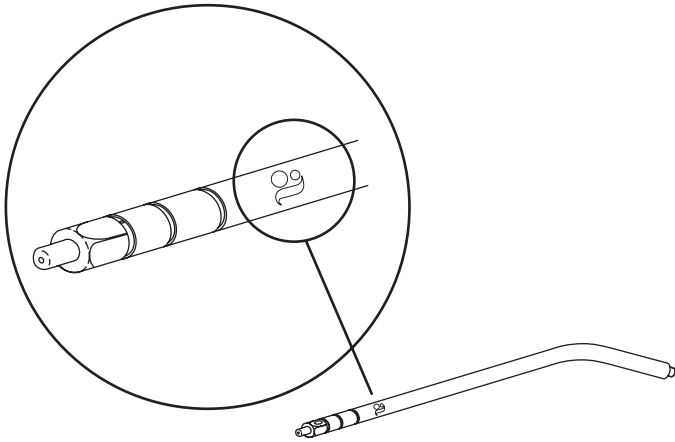

AVISO Utilize apenas pontas de seringa A-dec para as seringas A-dec. As pontas de seringa A-dec foram concebidas e fabricadas para utilização com as seringas A-dec. Se utilizar as pontas da seringa fabricadas por outra empresa que não a A-dec, pode provocar a projeção da ponta da seringa. A projeção da ponta pode resultar na ingestão ou aspiração da ponta e exige assistência médica imediata.

Dispositivo de retenção com bloqueio da ponta da seringa

O dispositivo de retenção com bloqueio possui uma superfície exterior hexagonal que permite apertar o dispositivo de retenção, evitando que a ponta rode facilmente. Neste caso, a ponta pode ser utilizada como afastador de bochechas.




Instalar a ponta da seringa



AVISO Se não sentir dois cliques durante a instalação da ponta da seringa, não utilize a seringa. Isto significa que os O-rings no interior do conjunto de retenção da ponta da seringa estão danificados e poderão permitir que a ponta da seringa seja projetada. Substitua os O-rings antes de utilizar a seringa.

1. Insira a ponta da seringa no conjunto de retenção até sentir dois cliques.

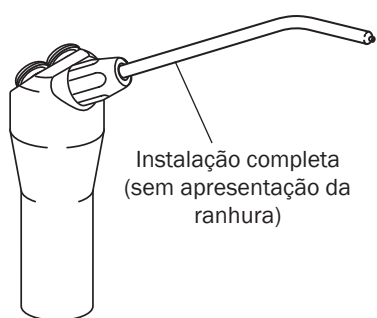

ATENÇÃO A ponta da seringa pode ser projetada caso não esteja totalmente encaixada.

2. Direcione a seringa para o chão e pressione várias vezes o botão de ar para se certificar de que a ponta está bem instalada.

Remover a ponta da seringa

1. Desaperte o dispositivo de retenção com bloqueio.
2. Puxe a ponta a direito da seringa para a remover.

Restringir a rotação da ponta

Se utilizar a ponta da seringa como afastador de bochechas, deve restringir a rotação da ponta.



ATENÇÃO Se apertar o dispositivo de retenção com bloqueio numa ponta da seringa instalada inadequadamente, irá partir o mandril interno, dificultando a remoção da ponta da seringa e impossibilitando a instalação de uma nova ponta.

1. Utilize a chave de plástico para apertar o dispositivo de retenção com bloqueio.



NOTA A chave foi concebida para ser esterilizada. Para obter instruções, consulte "Assepsia" na página 6.

2. Certifique-se de que a ponta não roda facilmente.

Ajustes

Fluxo de ar e água

Os ajustes do fluxo de ar e água são realizados através de uma mola de aperto ou de uma válvula de controlo. Utilize a tabela abaixo para identificar a localização e o método de ajuste do seu módulo de peças de mão ou módulo de assistente.


Modelo	Localização do controlo do fluxo	Método de ajuste
<ul style="list-style-type: none"> Módulo de peças de mão A-dec 300 Módulo de peças de mão A-dec 500 (versão A) Módulo de peças de mão Performer® 	Cabeça de controlo	Mola de aperto
<ul style="list-style-type: none"> Módulo de assistente A-dec 351 Módulo de assistente A-dec 500 Módulo de assistente Radius® 7115 	Braço de elevação da cadeira	Mola de aperto
<ul style="list-style-type: none"> Módulo de assistente com peças de mão A-dec 352 e 353 Módulo de assistente Radius 7285 Módulo de assistente Cascade® 4635 Módulo de assistente Performer 	Centro de suporte	Mola de aperto
<ul style="list-style-type: none"> Módulo de peças de mão Cascade Módulo de peças de mão Decade® 	Cabeça de controlo	Válvula de controlo do fluxo no bloco de controlo



NOTA Se o seu produto não estiver listado, contacte o seu revendedor autorizado da A-dec para obter mais informações.


Ajustar o fluxo com uma mola de aperto

1. Rode o parafuso de afinação do tubo de água no sentido dos ponteiros do relógio para reduzir o fluxo de água ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para aumentar o fluxo.
2. Rode o parafuso de afinação do tubo de ar no sentido dos ponteiros do relógio para reduzir o fluxo de ar ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para aumentar o fluxo.
3. Pressione ambos os botões da seringa para testar a função tríplice (ar/água/spray).

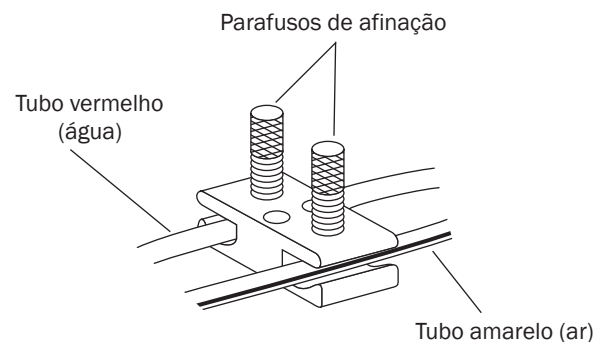

Ajustar o fluxo com uma válvula de controlo do fluxo

1. Rode a válvula de controlo do fluxo superior no sentido dos ponteiros do relógio para diminuir o fluxo de água ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para aumentar o fluxo de água.
2. Rode a válvula de controlo do fluxo inferior no sentido dos ponteiros do relógio para diminuir o fluxo de ar ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para aumentar o fluxo de ar.
3. Pressione ambos os botões da seringa para testar a função tríplice (ar/água/spray).

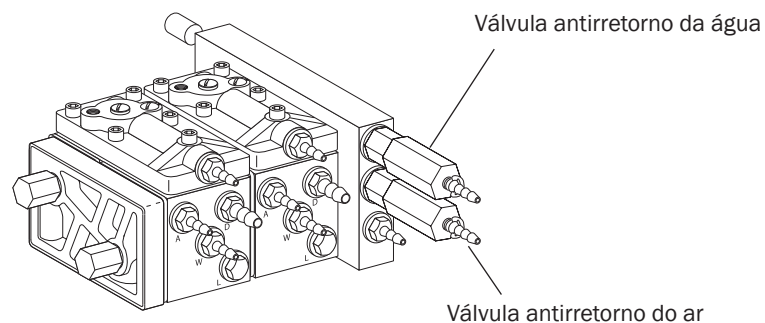

Ajuste de temperatura da seringa de água quente

Se estiver a utilizar a seringa de água quente opcional e pretender ajustar a temperatura da água, contacte o seu revendedor autorizado da A-dec.

Resolução de problemas

Utilize a seguinte tabela de resolução de problemas para identificar e resolver problemas relacionados com a seringa.

Problema	Causa possível	Ação
A seringa apresenta fuga de ar ou água num botão.	O-rings danificados no botão.	Substitua o conjunto dos botões (ref.ª 23.1234.00).
A ponta da seringa goteja quando a seringa não está a ser utilizada.	O-rings danificados no botão da água.	Substitua o botão da água (ref.ª 23.1234.00).
Um breve fluxo de água é pulverizado a partir da ponta quando o botão do ar é pressionado.	Ponta da seringa danificada ou instalada inadequadamente.	Retire e volte a instalar corretamente a ponta da seringa. Substitua a ponta da seringa se continuar a apresentar fugas (ref.ª 23.0872.01).
Fuga de ar ou água a partir do conector da seringa.	O conector da seringa não está firmemente ligado à seringa. Os O-rings no terminal estão danificados.	Aperte o conector da seringa na seringa. Substitua os O-rings (ref.ª 030.002.02) no terminal e lubrifique com o lubrificante de silicone A-dec.
Fuga de ar a partir da parte superior do conjunto de retenção da ponta.	A ponta da seringa está danificada. Os O-rings internos do dispositivo de retenção estão danificados.	Substitua por uma nova ponta (ref.ª 23.0872.01). Substitua os dois O-rings internos (ref.ª 035.062.00) do conjunto de retenção.
A ponta da seringa é difícil de instalar.	Os O-rings internos do dispositivo de retenção foram lubrificados com um lubrificante à base de petróleo. O conjunto de retenção da ponta sofreu danos.	Substitua os O-rings (ref.ª 034.003.01) e remova o restante lubrificante do dispositivo de retenção. Utilize o lubrificante de silicone A-dec nos novos O-rings. Substitua o conjunto de retenção da ponta (sem bloqueio, ref.ª 23.1112.00/com bloqueio, ref.ª 23.1090.00).

Resolução de problemas (continuação)

Problema	Causa possível	Ação
Fuga de água a partir da base do conjunto de retenção da ponta.	A ponta não está totalmente instalada. Falha no O-ring pequeno no conjunto de retenção.	Insira totalmente a ponta na respetiva posição com a terceira ranhura oculta. Substitua o O-ring ou o conjunto de retenção (ref.º 034.003.01).
A ponta da seringa está solta no conjunto de retenção.	Está a ser utilizada uma ponta da seringa que não é da A-dec. Os O-rings do dispositivo de retenção estão gastos ou danificados.	Substitua por uma ponta da seringa A-dec (ref.º 23.0872.01). Substitua os O-rings (ref.º 035.062.00).

Assepsia

As seringas A-dec são consideradas um acessório não crítico. Utilize proteções descartáveis ou um desinfetante hospitalar para desinfetar a seringa depois da utilização em cada paciente ou quando a proteção tenha sido comprometida. As seringas A-dec são concebidas para suportar esterilização por vapor, a qual pode ser utilizada em substituição ou como complemento às proteções e aos desinfetantes.

Todas as pontas de seringa são consideradas acessórios semicríticos e devem ser esterilizadas depois de cada utilização. A A-dec projetou as pontas de seringa para serem autoclaváveis ou esterilizadas por calor. Retire a seringa e as pontas da seringa do módulo de peças de mão para esterilização.

Desligar a seringa

1. Desligue o módulo de peças de mão e depressurize o sistema pressionando os botões de ar e água na seringa sobre o lavatório, a cuspideira ou um recipiente adequado.
2. Desaparafuse o corpo da seringa até que a cabeça da seringa se solte da mangueira da seringa. Depois de desligar a seringa, qualquer água restante na cabeça da seringa irá escorrer.

Pré-limpeza da ponta da seringa

1. Retire a ponta da seringa.
2. Mergulhe a ponta numa solução de repouso até estar pronta para uma limpeza ultrassónica.

Limpeza da seringa e/ou da ponta da seringa

Limpeza manual

1. Escove suavemente as roscas da seringa com uma escova de cerdas de latão ou de nylon.
2. Utilize uma seringa de irrigação com água limpa para enxaguar os lúmenes da ponta.
3. Lave a seringa e a ponta da seringa com água limpa.
4. Remova a água em excesso e deixe secar antes de esterilizar.

Limpeza por banho ultrassónico

1. Utilize um detergente enzimático ou para limpeza geral.
2. Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do banho ultrassónico e pelo fabricante do detergente quanto ao tempo de processamento.
3. Lave a seringa e a ponta da seringa com água limpa.
4. Remova a água em excesso e deixe secar antes de esterilizar.

Máquina de lavar/desinfetar térmica automática



ATENÇÃO A utilização de máquinas de lavar e desinfetar térmicas automáticas não é recomendada, uma vez que pode danificar a seringa e o acabamento da ponta da seringa. O processamento de metais diferentes pode causar o embaciamento dos instrumentos.

Desinfetar a ponta da seringa

1. Enxague as pontas com álcool isopropílico.

Embalagem

Os instrumentos devem ser embalados numa bolsa ou num invólucro de esterilização para manter a esterilidade, a menos que os instrumentos se destinem a ser utilizados imediatamente após a esterilização. Para informações mais específicas sobre requisitos de utilização, consulte as instruções de utilização fornecidas com o esterilizador e com o material de embalagem de esterilização. Recomenda-se a utilização de integradores ou indicadores de esterilização.

Esterilizar

1. Esterilize por calor a seringa e a ponta da seringa numa autoclave a vapor para o seguinte:
 - **Deslocamento por gravidade** – 30 minutos a uma temperatura pré-estabelecida de 121 °C (250 °F)
 - **Remoção do ar dinâmica** – 4 minutos a uma temperatura pré-estabelecida de 134 °C (273 °F)
2. Permita que a embalagem arrefeça e seque antes de a remover do esterilizador para evitar contaminação cruzada.

Armazenamento

Armazene num local seco e isento de pó. Não armazene juntamente com instrumentos não esterilizados. Consulte as instruções de utilização do fabricante da embalagem de esterilização para determinar durante quanto tempo a esterilidade pode ser mantida.

Testar

Antes de utilizar uma seringa e uma ponta da seringa que tenham sido esterilizadas, ligue o módulo de peças de mão e teste a seringa para se certificar de que a ponta não é projetada.

Manutenção

A seringa foi concebida para que a respetiva manutenção seja facilmente efetuada no consultório. As peças da seringa sujeitas a desgaste sob utilização normal são fornecidas num kit de reparação da seringa, disponibilizado junto do seu revendedor autorizado da A-dec.

É essencial uma manutenção e um tratamento adequados da sua seringa A-dec para garantir a segurança dos seus pacientes e a fiabilidade deste instrumento de precisão.

Lubrificante de silicone A-dec

Utilize apenas lubrificante de silicone A-dec para lubrificar os conjuntos dos botões da seringa e os O-rings no conjunto de retenção da ponta da seringa.



ATENÇÃO A utilização de lubrificantes à base de petróleo (vaselina, cremes ou loções) provoca a dilatação e/ou a deterioração dos O-rings na seringa, resultando na falha ou na avaria da seringa.


Peças de substituição A-dec

As peças de substituição A-dec foram concebidas especificamente para a sua seringa A-dec, de modo a garantir o funcionamento adequado da seringa.

A A-dec recomenda que substitua os dois O-rings internos (ref.^a 035.062.00) e o O-ring pequeno (ref.^a 034.003.01) do conjunto de retenção da ponta da seringa, pelo menos, uma vez por ano. Lubrifique os O-rings com o lubrificante de silicone A-dec (ref.^a 98.0090.01) quando os substituir.

Ferramentas recomendadas

Utilize a chave (ref.^a 98.0900.00) do kit (ref.^a 23.1090.00) para apertar o dispositivo de retenção com bloqueio (ref.^a 23.1103.00). Utilize o adaptador (ref.^a 23.1354.00) para apertar o dispositivo de retenção sem bloqueio (dispositivo de retenção liso, ref.^a 23.1111.01).

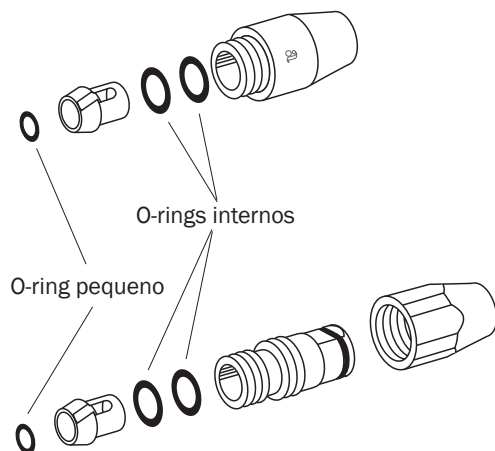

Sede da A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
Estados Unidos
Telef.: 1 800 547 1883 nos EUA/CAN
Telef.: +1 503 538 7478 fora dos EUA/CAN
Fax: 1 503 538 0276
www.a-dec.com

A-dec Austrália

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Austrália
Telef.: 1 800 225 010 na AUS
Telef.: +61 (0) 2 8332 4000 fora da AUS

A-dec China

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311106, Zhejiang, China
Telef.: 400 600 5434 na China
Telef.: +86 571 89026088 fora da China

A-dec Reino Unido

Representante autorizado da UE
Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Inglaterra
Telef.: 0800 ADEC UK (2332.85) no Reino Unido
Telef.: +44 (0) 24 7635 0901 fora do Reino Unido

Especificações, garantia e assistência aos produtos

Requisitos mínimos de ar e água

Ar: 71 sl/min (2,5 scfm) a 550 kPa (80 psi)

Água: 5,7 l/min (1,50 gpm) a 270 kPa (40 psi)



IMPORTANTE Para saber mais sobre especificações adicionais, a identificação dos símbolos, garantia e outros requisitos de regulamentação, consulte o documento *Informações regulamentares, especificações e garantia* (ref.^a 86.0221.08), disponível na biblioteca de documentos em www.a-dec.com.



NOTA As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os requisitos podem variar de país para país. Para mais informações, contacte o seu revendedor autorizado da A-dec.

Assistência aos produtos

A assistência aos produtos é disponibilizada através do revendedor local autorizado da A-dec. Para informações sobre a assistência ou para localizar um revendedor autorizado, contacte a A-dec através do número 1 800 547 1883 nos Estados Unidos e Canadá ou através do número 1 503 538 7478 no resto do mundo ou visite www.a-dec.com.



86.0728.08 Rev A

Direitos de autor 2018 A-dec Inc.

Todos os direitos reservados.

IFUse1F5